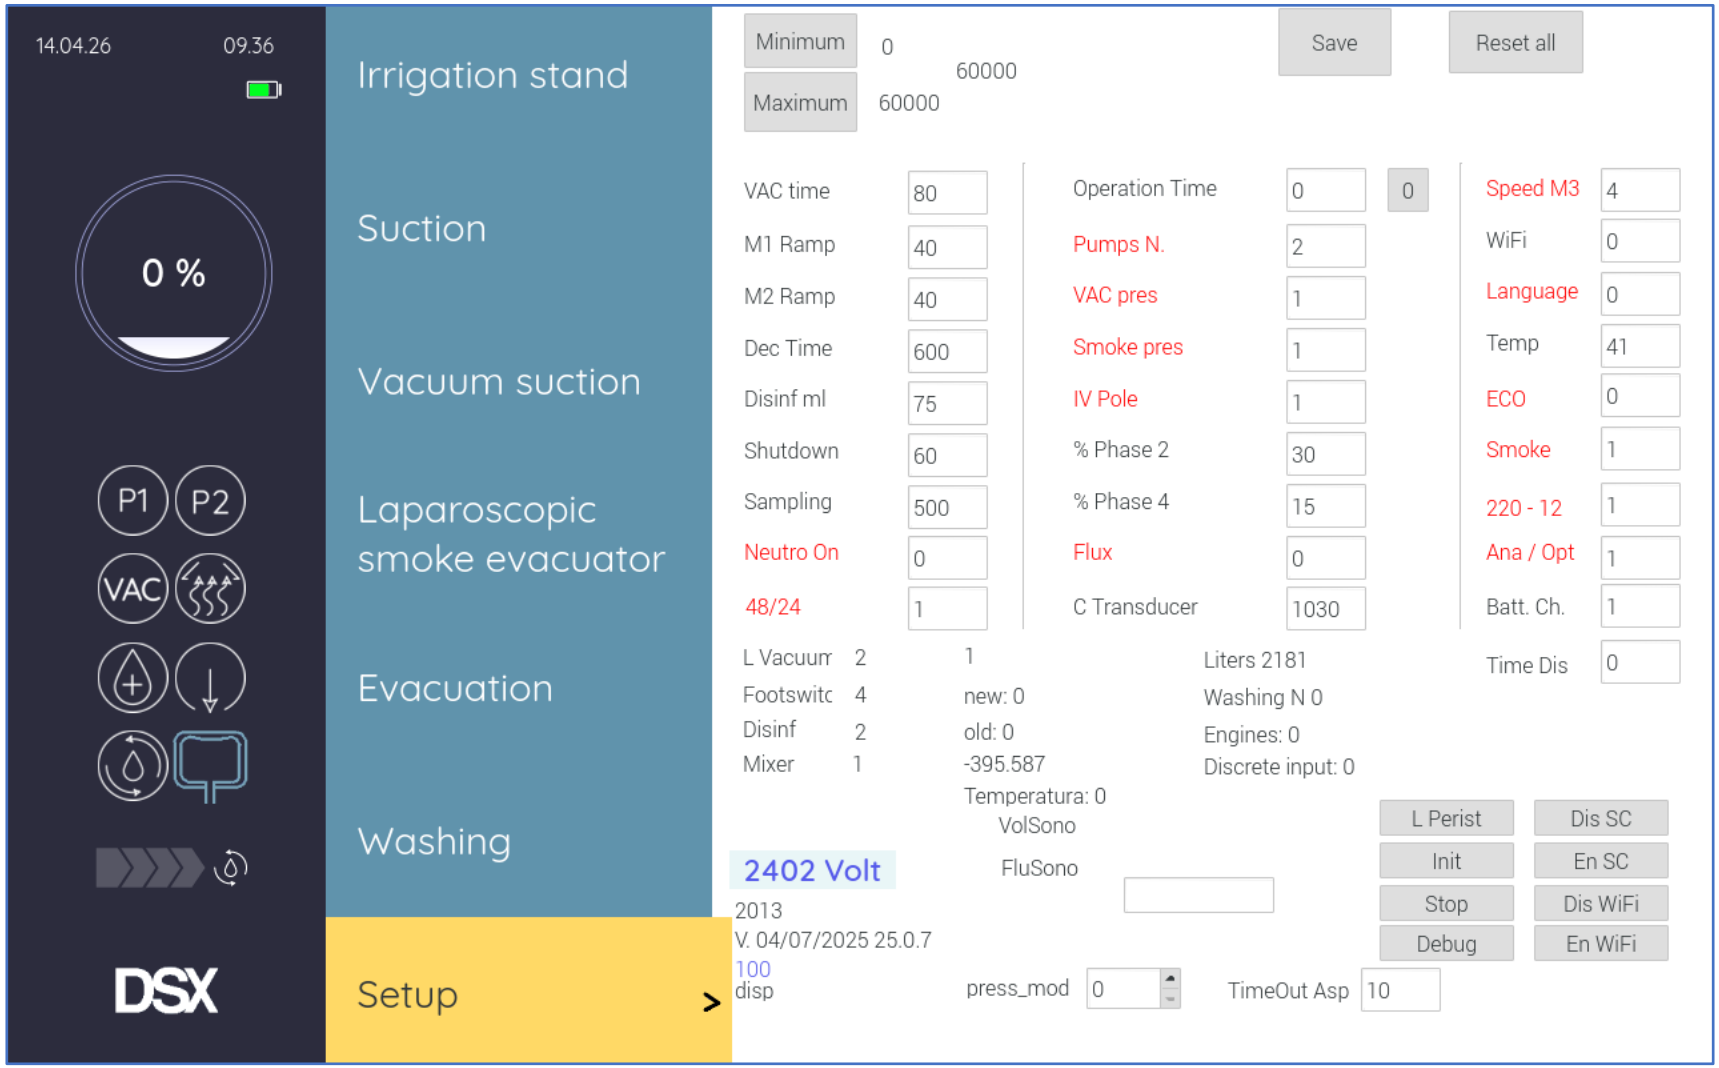
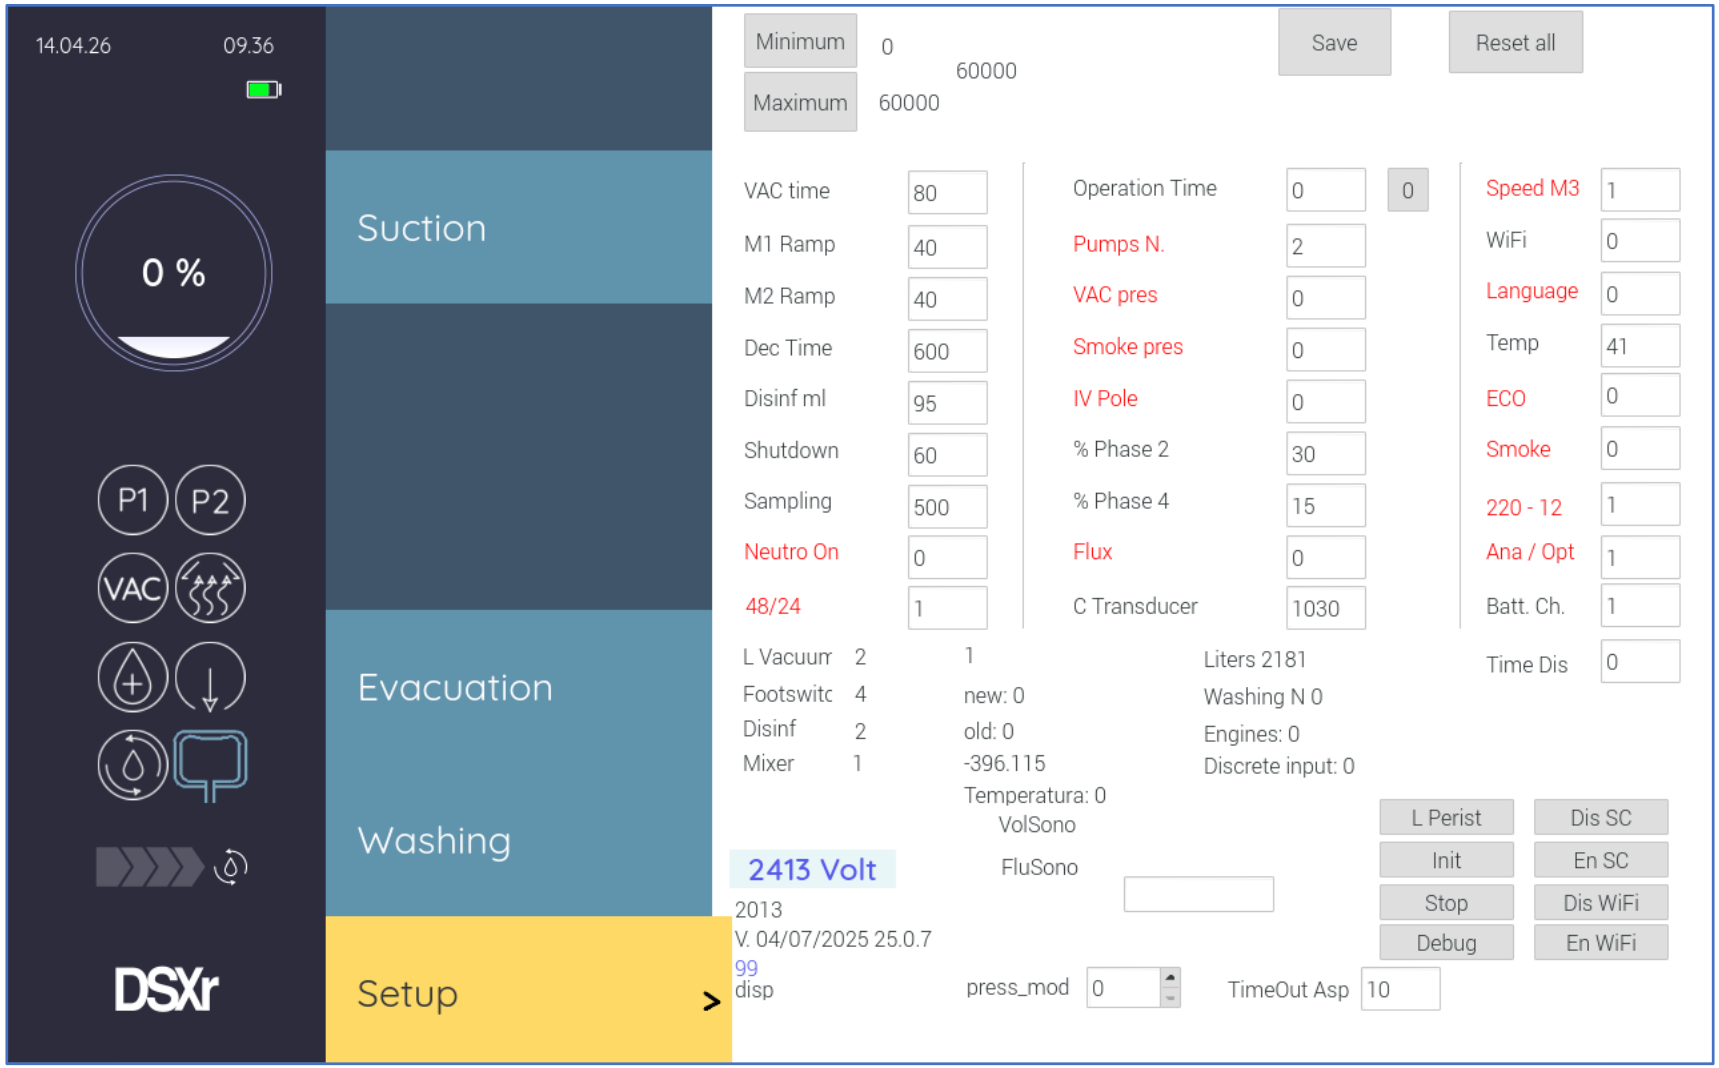
DSX


14.04.26
09.36
0 %
P1
P2
VAC
DSX
Irrigation stand
Suction
Vacuum suction
Laparoscopic smoke evacuator
Evacuation
Washing
Setup
>
Minimum
0
60000
Maximum
60000
Save
Reset all
VAC time 80
M1 Ramp 40
M2 Ramp 40
Dec Time 600
Disinf ml 75
Shutdown 60
Sampling 500
Neutro On 0
48/24 1
Operation Time 0 0
Pumps N. 2
VAC pres 1
Smoke pres 1
IV Pole 1
% Phase 2 30
% Phase 4 15
Flux 0
C Transducer 1030
Speed M3 4
WiFi 0
Language 0
Temp 41
ECO 0
Smoke 1
220 - 12 1
Ana / Opt 1
Batt. Ch. 1
Time Dis 0
L Vacuum 2
Footswitc 4
Disinf 2
Mixer 1
1
new: 0
old: 0
-395.587
Temperatura: 0
VolSono
FluSono
Liters 2181
Washing N 0
Engines: 0
Discrete input: 0
2402 Volt
2013
V. 04/07/2025 25.0.7
100
disp
press_mod 0
TimeOut Asp 10
L Perist
Init
Stop
Debug
Dis SC
En SC
Dis WiFi
En WiFi

DSXr


14.04.26
09.36
0 %
P1
P2
VAC
DSXr
Suction
Evacuation
Washing
Setup
Minimum
0
60000
Maximum
60000
Save
Reset all
VAC time
80
M1 Ramp
40
M2 Ramp
40
Dec Time
600
Disinf ml
95
Shutdown
60
Sampling
500
Neutro On
0
48/24
1
Operation Time
0
0
Pumps N.
2
VAC pres
0
Smoke pres
0
IV Pole
0
% Phase 2
30
% Phase 4
15
Flux
0
C Transducer
1030
Speed M3
1
WiFi
0
Language
0
Temp
41
ECO
0
Smoke
0
220 - 12
1
Ana / Opt
1
Batt. Ch.
1
Time Dis
0
L Vacuum
2
Footswitc
4
Disinf
2
Mixer
1
1
new: 0
old: 0
-396.115
Temperatura: 0
VolSono
FluSono
Liters 2181
Washing N 0
Engines: 0
Discrete input: 0
2413 Volt
2013
V. 04/07/2025 25.0.7
99
disp
press_mod
0
TimeOut Asp
10
L Perist
Init
Stop
Debug
Dis SC
En SC
Dis WiFi
En WiFi

PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS SÉLECTIONNABLES	VALEURS PAR DÉFAUT		
Minimum	Valeur de capacité minimale du réservoir principal, mesurée lors de l'étalonnage du capteur de poids	Mesuré lors de l'étalonnage « minimum »	Environ 300 à 500		
Maximum	Valeur de capacité maximale du réservoir principal, mesurée lors de l'étalonnage du capteur de poids	Mesuré lors de l'étalonnage « maximum »	Environ 60 000		
Temps avant arrêt	Temps d'attente (en secondes) avant l'arrêt de la pompe de refoulement pendant l'évacuation	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	80		
Temps de rampe M1	Taux d'augmentation de la vitesse d'aspiration de la pompe (P1), du démarrage à l'atteinte de la vitesse sélectionnée. Plus la valeur est basse, plus le taux est élevé.	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	40		
Temps de rampe M2	Taux d'augmentation de la vitesse d'aspiration de la pompe (P2), du démarrage à l'atteinte de la vitesse sélectionnée. Plus la valeur est basse, plus le taux est élevé.	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	40		
Temps de décontamination	Temps de contact (en secondes) du désinfectant dans le réservoir principal pendant la phase de décontamination du cycle de lavage	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	600		
Désinf ml	Valeur correspondant aux millilitres (mL) de désinfectant utilisés dans les phases de lavage qui utilisent du désinfectant	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	DSX 75	DSXr 95	DSXr -e 95

PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS SÉLECTIONNABLES	VALEURS PAR DÉFAUT		
Fermeture	Minutes écoulées entre la fin de la dernière action du système ou de la dernière interaction de l'opérateur avec l'interface utilisateur, et l'arrêt du système. Ceci s'applique uniquement lors du fonctionnement sur batterie.	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	60		
Échantillonnage	Millisecondes entre deux relevés de données consécutifs. Paramètre logiciel.	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	500		
Neutro On	Activation permanente de la neutralisation (activée/désactivée)	0 : désactivé 1 : activé	0		
48/24	Nombre d'heures au-delà duquel l'appareil est bloqué, rendant un cycle de lavage obligatoire. Le décompte commence à partir de la première activation de l'aspiration suivant le cycle de lavage précédent.	1 h 48 2: 24 heures	1		
Temps de fonctionnement	Durée d'utilisation de l'appareil depuis le dernier cycle de lavage	Calcul automatique	0+		
Pompes N.	Nombre de pompes **(aspiration)**	1 : une pompe d'aspiration 2 : deux pompes d'aspiration	DSX 2	DSXr 2	DSXr -e 1
VAC press	Aspiration haute pression **(aspiration par le vide)** activée/désactivée	0 : désactivé 1 : activé	DSX 1	DSXr 0	DSXr -e 0
Activation Asp. Fumée	**Laparoscopie –** Fonction d'évacuation des fumées activée/désactivée	0 : désactivé 1 : activé	DSX 1	DSXr 0	DSXr -e 0

PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS SÉLECTIONNABLES	VALEURS PAR DÉFAUT		
Potence électrique IV	**Activation/désactivation du réglage électrique de la hauteur de la potence électrique.** *La potence électrique pour perfusion IV est un accessoire optionnel pour le DSXr	0 : désactivé 1 : activé	DSX 1	DSXr * 0/1	DSXr -e 0
% Phase 2	Pourcentage de remplissage du réservoir principal et des pompes P1 et P2 pendant la phase 2 (prélavage) du cycle de lavage.	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	30		
% Phase 4	Pourcentage de remplissage du réservoir principal et des pompes P1 et P2 pendant la phase 4 (désinfection) du cycle de lavage.	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	15		
Flux	Présence / absence du débitmètre	0 : absent 1 : présent	0		
Transducteur C	Coefficient de lecture du transducteur	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	1030		
Vitesse M3	Niveau de vitesse d'aspiration de la pompe à vide (P3)	Paramètre fixe Ne doit pas être modifié	DSX 4	DSXr 1	DSXr -e 1
Wi-Fi	Wi-Fi activé / désactivé	0 : désactivé 1 : activé	0		

PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS SÉLECTIONNABLES	VALEURS PAR DÉFAUT		
Langue	Paramètres de langue de l'appareil	0-12	0 : Anglais 1 : Italien 2 : Français 3 : Allemand 4 : Suédois 5 : Finlandais 6 : Portugais 7 : Letton 8 : Grec 9 : Polonais 10 : Roumain 11 : Espagnol 12 : Néerlandais		
Temp	Température maximale admissible (en °C) des fluides aspirés. Si la température du fluide dépasse cette valeur, l'appareil avertit l'opérateur.	41-60	41		
ÉCO	Mode **ECO** activé / désactivé	0 : désactivé 1 : activé	DSX 0	DSXr 0	DSXr -e 1
Fumée	Présence/absence de la pédale	0 : absent 1 : présent	DSX 1	DSXr 0	DSXr -e 0
220 – 12	tension d'alimentation de la pompe de vidange	0: 220 V CA 1: 12 V CC	0/1 Selon le modèle de pompe de vidange		
Ana/Opt	Présence de capteurs analogiques/optiques	0 : capteurs analogiques 1 : capteurs optiques	0/1 Selon le type de capteurs		

PARAMÈTRE	DESCRIPTION	VALEURS SÉLECTIONNABLES	VALEURS PAR DÉFAUT
Batt. Ch .	Batterie complètement chargée ou non	Calcul automatique 0 : charge incomplète 1 : charge complète	0/1